

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.083.2023 BS – sprzęt medyczny jednorazowego użytku stosowany w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy projektu umowy

„Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 7 ust. 1A wzoru Umowy. Zamawiający w § 7 ust. 1A wskazał: Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:

a) za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 0,1% ceny brutto dostawy za każdy dzień zwłoki. W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,1% ceny brutto dostawy za każdy dzień zwłoki, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy.

Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,1% ceny brutto dostawy za każdy dzień zwłoki, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający.

W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”

W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 7 ust 1A wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,5% wartości.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

PYTANIE NR 2: dotyczy projektu umowy

„W przypadku, gdy producentem produktów medycznych dostarczanych w ramach Umowy jest podmiot inny niż Wykonawca, Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego, przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na producenta dostarczanych produktów medycznych lub inną spółkę z grupy kapitałowej producenta. W celu przeniesienia praw i obowiązków Wykonawca, Zamawiający oraz producent lub inna spółka z grupy kapitałowej producenta podpiszą umowę trójstronną przenosząc a, prawa i obowiązki z niniejszej Umowy. Wszelkie inne postanowienia Umowy pozostaną bez zmian.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

PYTANIE NR 3: dotyczy części nr 21, poz. 1, 2, 3

„Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 zestawy do kaniulacji dużych naczyń o poszczególnych parametrach:

- pozycja 1 rozmiar 6F (kanał 14G), rozmiar 7F(kanał 13G);

- pozycja 2 rozmiar 7F (kanały 16G, 18G, 18G)

- pozycja 3 rozmiar 7F (kanały 14G, 17G, 19G, 19G)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4: dotyczy części nr 21

„Czy możliwe jest przedstawienie propozycji produktu równoważnego, który ma parametry techniczne i funkcjonalne zbliżone do opisanych w przedmiocie zamówienia?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 5: dotyczy części nr 21

„Czy w przypadku produktu równoważnego, który spełnia wymagania techniczne i funkcjonalne, istnieje konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów, takich jak certyfikaty czy badania, opinie, aby potwierdzić jego jakość i zgodność?”

ODPOWIEDŹ

Nie dotyczy.

PYTANIE NR 6: dotyczy części nr 21

„Czy Zamawiający w celu uzyskania oferty konkurencyjnej, dopuści cewniki o niewielkich różnicach technicznych, lecz tej samej lub lepszej funkcjonalności leczniczej :

W pozycji 1,2,3 oferujemy strzykawkę 5ml zamiast 10ml

W pozycji 1 oferujemy cewniki dwukanałowy 7F/2x16G dł. 20cm zamiast 6F/15G, 7F/14G dł. 20 cm

W pozycji 2 oferujemy cewnik trzykanałowy 7F/1x16G, 2x18G dł. 20cm zamiast 7F/14G dł. 20 cm

W pozycji 3 oferujemy cewnik czterokanałowy 7F/1x14G, 1x16G, 2x18G dł. 20 cm zamiast 7F/14G dł. 20 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 7: dotyczy części nr 7, poz. 1

„Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w pozycji 1 dopuści rurkę tracheostomijną z regulowanym położeniem kołnierza, z termoplastycznego PCW i silikonowaną, ze standardowym mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny z rozmiarem rurki, linia Rtg na całej długości rurki, przezroczysty kołnierz, w zestawie tasiemki mocujące; sterylna, pakowana pojedynczo; rozmiary – zgodnie z SWZ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 8: dotyczy części nr 7, poz. 1

„Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w pozycji 1 dopuści rurkę tracheostomijną (bez regulacji położenia kołnierza) - taką, jak opisaną w pozycji 2 pakietu; rozmiary od 6,0 do 10,0mm (co 1,0 mm) oraz 7,5mm i 8,5mm (do wyboru)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 9: dotyczy części nr 7, poz. 1

„Czy Zamawiający w Pakiecie 7 wyrazi zgodę na wykreślenie bądź wydzielenie pozycji 1 do odrębnego pakietu?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 10: dotyczy części nr 7, poz. 3

„Czy Zamawiający w Pakiecie 7 mógłby potwierdzić, że w pozycji 3 oczekuje rozmiarów: 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 (w szczegółowym wykazie cen jest wskazany m.in. rozmiar 9,1)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza (patrz zmiana SWZ).

PYTANIE NR 11: dotyczy części nr 34

„Czy Zamawiający w Pakiecie 34 wyraziłby zgodę na rezygnację z wymogu dostarczenia próbki do pozycji 2, (próbka wymagana do pozycji 1 zawiera już wszystkie elementy zestawu uzupełniającego opisanego w pozycji 2)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 12: dotyczy części nr 19 poz. 1, 2

„Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie kocyków wyposażonych w uniwersalny port pozwalający na swobodne obracanie rury ogrzewacza względem portu kocyka, którego rozmiar portu

grzewczego pozwala na szczelne zastosowanie z przewodem grzewczym urządzenia bez konieczności stosowania jakichkolwiek innych adapterów, mocowań nie wymagających dodatkowych taśm mocujących, pasujących technicznie do ogrzewaczy wskazanych przez Zamawiającego. Oferowane kocyki są znane zamawiającemu z aktualnie obowiązującej umowy.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 13: dotyczy części nr 3, poz. 1

„Prosimy o dopuszczenie mankietu w kształcie baryłki, standardowy, bez ograniczonej przenikalności N₂O, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 14: dotyczy części nr 6, poz. 1

„Prosimy o dopuszczenie rurek wersji północ wstępnie uformowane rurki nosowe z mankiem w kształcie baryłki o dużej objętości i niskim ciśnieniu.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 15: dotyczy części nr 6, poz. 2

„Prosimy o dopuszczenie rurek wersji południe wstępnie uformowane rurki ustne z mankiem w kształcie baryłki o dużej objętości i niskim ciśnieniu.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 16: dotyczy części nr 12, poz. 1

„Prosimy o dopuszczenie filtra bez informacji na temat temperatury zwrotnej przy VT750ml, mimo, że jesteśmy producentem filtrów nie oznaczamy tego parametru dla filtra. W zamian podajemy informacje o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 750ml: 9.44.. Pozostałe parametry spełniają oczekiwania zawarte w SWZ przez Zamawiającego.?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 17: dotyczy części nr 12, poz. 2

„Prosimy o dopuszczenie filtra bez informacji na temat temperatury zwrotnej przy VT750ml, mimo, że jesteśmy producentem filtrów nie oznaczamy tego parametru dla filtra. W zamian podajemy informacje o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 750ml: 9.44.. Pozostałe parametry spełniają oczekiwania zawarte w SWZ przez Zamawiającego.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 18: dotyczy części nr 12, poz. 3

„Prosimy o dopuszczenie filtra o oporze przepływu przy 60l/min 2,6cmH₂O oraz bez informacji na temat temperatury zwrotnej przy mimo, że jesteśmy producentem filtrów nie oznaczamy tego parametru dla filtra. W zamian podajemy informacje o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.61; 500ml: 6.90; 750ml: 7.69 ;1000ml: 8.92; 1200ml: 9.30. Pozostałe parametry spełniają oczekiwania zawarte w SWZ przez Zamawiającego.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 19: dotyczy części nr 13, poz. 1

„Prosimy o dopuszczenie filtra z zakresem objętości oddechowej 50-250ml, posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.11; , przy Vt-100 ml nie był to oznaczany u nas parametr. Pozostałe parametry spełniają oczekiwania zawarte w SWZ przez Zamawiającego.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 20: dotyczy części nr 13, poz. 2

„Prosimy o dopuszczenie filtr wg opisu: hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,99% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 14,5 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej max 13,4 ml;

posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.11; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 10.1; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 50 - 250 ml; posiadający opór przepływu przy 20 l/min.1,4 cm H₂O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15, pakowany po 20 szt. opór przy przepływie 10l/min oraz skuteczność nawilżania dla Vt=70 nie były mierzone.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 21: dotyczy części nr 15

„Prosimy o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci bez podania parametru temp zwrotna, bowiem jako producent filtrów nie oznaczamy takiego parametru dla filtrów, pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 22: dotyczy części nr 15

„Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznego wymiennika ciepła i wilgoci.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 23: dotyczy części nr 21, poz. 1, 2, 3

„Prosimy o dopuszczenie zestawu do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera brandu ARROW

W poz. 1 Cewniki centralny 2-światłowy 7Fr/18,14Ga/ 20 cm oraz 7Fr/16,16Ga/20cm

W skład zestawu ma wchodzić: igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, przewodnik o średnicy 0,032” o długości 60cm na powierzchni znaczniki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, przewodnica umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzenie przewodnika jedną ręką, 2-światłowy cewnik z poliuretanu kontrastujący w RTG, strzykawka 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące.

W poz. 2 Cewnik centralny 3-światłowy o wysokim przepływie 7Fr/16,18,18 Ga/ 20 cm.

W skład zestawu ma wchodzić igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, przewodnik o średnicy 0,032” o długości 60cm na powierzchni znaczniki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, przewodnica umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzenie przewodnika jedną ręką, 3-światłowy cewnik z poliuretanu kontrastujący w RTG; strzykawka 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące.

W poz. 3 Cewniki 4-światłowe 8,5Fr/18,14,18,16Ga/ 20 cm.

W skład zestawu ma wchodzić igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, przewodnik druciany o średnicy 0,032” o długości 60cm na powierzchni znaczniki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, przewodnica umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzenie przewodnika jedną ręką, 4-światłowy cewnik z poliuretanu kontrastujący w RTG, strzykawka 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 24: dotyczy części nr 27

„Prosimy o dopuszczenie wg opisu układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o średnicy 22mm i długości 180 cm posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów równoległy, kolanko, dodatkową rurę o długości 80 cm oraz worek oddechowy o pojemności 2L, dodatkowe złącze proste 22M/22M. Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/ papier, sterylny. Układ posiadające elastyczne końcówki na wlocie i wylocie. 10 szt. w opakowaniu zbiorczym.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 25: dotyczy części nr 27

„Prosimy o dopuszczenie wg opisu: układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o średnicy 22mm i długości 180 cm posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów równoległy, kolanko z portem LUER z zakręcanym koreczkiem, dodatkową rurę o długości 150 cm oraz worek oddechowy o pojemności 2L, dodatkowe złącze proste 22M/22M. Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/ papier, sterylny. Układ posiadające wszystkie elastyczne końcówki na wlocie i wylocie oraz Y. 10 szt. w opakowaniu zbiorczym.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 26: dotyczy części nr 28

„Prosimy o dopuszczenie wg opisu: Układ oddechowy dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o średnicy 22mm i długości 180 cm posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów równoległy, kolanko. Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/ papier, sterylne. Układ posiadające elastyczne końcówki na włocie i wylocie. 10 szt. w opakowaniu zbiorczym.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 27: dotyczy części nr 20

„Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbki produktu? Opisane linie do przepływowego podgrzewania płynów i krwi są znane i używane przez Zamawiającego. Dodatkowo kryteria wyboru nie uwzględniają oceny jakościowej.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 28: dotyczy części nr 32, poz. 1, 2

„Czy Zamawiający, w związku z zakończeniem produkcji przez producenta, zgodzi się na wykreślenie lub wydzielenie do innego pakietu pozycji 1 i 2. Pozytywna decyzja Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty na pozostały, dotychczas stosowany, asortyment.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wykreśla w opisie przedmiotu zamówienia z części nr 32 poz. 1 i 2 (patrz zmiana SWZ).

PYTANIE NR 29: dotyczy części nr 32

„Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbki produktu z pozycji 6? Opisane zestawy infuzyjne do pomp CADD są znane i używane przez Zamawiającego. Dodatkowo kryteria wyboru nie uwzględniają oceny jakościowej.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 30: dotyczy części nr 12, poz. 1, 2, 3

„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12, poz. 1, 2, 3 dopuści koreczek wkręcany na porcie do kapnometrii luer-lock, co jest rozwiązaniem bezpieczniejszym w użytkowaniu, czy oczekuje koreczka wciskanego, czy też dopuszcza obydwa rozwiązania?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza obydwa rozwiązania.

PYTANIE NR 31: dotyczy części nr 13

„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 dopuści koreczek wkręcany na porcie do kapnometrii luer-lock, co jest rozwiązaniem bezpieczniejszym w użytkowaniu, czy oczekuje koreczka wciskanego, czy też dopuszcza obydwa rozwiązania??”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza obydwa rozwiązania.

PYTANIE NR 32: dotyczy części nr 14

„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 dopuści koreczek wkręcany na porcie do kapnometrii luer-lock, co jest rozwiązaniem bezpieczniejszym w użytkowaniu, czy oczekuje koreczka wciskanego, czy dopuszcza obydwa rozwiązania?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza obydwa rozwiązania.

PYTANIE NR 33: dotyczy części nr 27

„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 27, pkt.1 dopuści standardowy worek oddechowy 2L litrowy, bez uchwytu do zawieszenia?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 34: dotyczy części nr 27

„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 27, pkt.1 dopuści standardowy worek oddechowy 2L litrowy, bez uchwytu do zawieszenia oraz dostarczenie wielorazowych uchwytów w ilości 10 sztuk?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 35: dotyczy części nr 35

„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 35, pkt.1 dopuści Zamknięty system do odsysania dróg oddechowych u dorosłych, do rurek intubacyjnych, długość cewnika STANDARDOWA 540 mm – rozmiar CH 14, CH 16 i tracheostomijnych, długość cewnika STANDARDOWA 305 mm – rozmiar CH 14, CH 16, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 36: dotyczy części nr 35

„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 35, pkt.1 dopuści Zamknięty system do odsysania dróg oddechowych - Cewnik posiadające 2 otwory boczne i 1 centralny, pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Dwa otwory boczne zamiast czterech w żaden sposób nie wpływają negatywnie na użytkowanie i osiągnięcie wymaganego celu. Ich budowa, wielkość i położenie jest tak dobrane, że identycznie działają, spełniają standardy i nie pogarszają działanie systemu.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 37: dotyczy części nr 12, poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr z wejściem prostym?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 38: dotyczy części nr 12, poz. 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr bateryjno-wirusowego z barierą mechaniczną w postaci celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci i membrany o metodzie działania ładunków intermolekularnych o korzystniejszej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej >99,999%?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 39: dotyczy części nr 13, poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr z wejściem prostym?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 40: dotyczy części nr 15

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nr 10. temperatury zwrotnej? przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymogów?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych bez oznaczenia temperatury zwrotnej.

PYTANIE NR 41: dotyczy części nr 26 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny układ oddechowy o dł. 180cm, z zachowaniem pozostałych parametrów?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 42: dotyczy części nr 27 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny układ oddechowy o regulowanej długości 180cm z dodatkową rurą rozciągliwą do 180cm z możliwością ustawienia na dowolnej długości m.in. 120-130 cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 43: dotyczy części nr 27 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny układ oddechowy o stałych długościach rur 180cm, dodatkowa rura 180cm, wewnątrznie gładkie ? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 44: dotyczy części nr 27 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny układ oddechowy o dł 180cm, z dodatkową rurą 90cm, wewnątrznie gładkie? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 45: dotyczy części nr 28

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka pakowanego osobno?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 46: dotyczy części nr 28

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie układu z dodatkową rurą o dł. 90cm?”


ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 47: dotyczy części nr 31, poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny przedłużacz obwodu oddechowego o następujących parametrach:

- gładki wewnątrznie PCV, karbowany na zewnątrz
- łącznik podwójnie obrotowy,
- port do odsysania z PCV elastyczny, port do bronchoskopii
- złącza 22mmF-22mmM/15mmF
- długość 15 cm.



”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 48: dotyczy części nr 29, poz. 1 i 2

„Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie: Pozycja 1 - elektrody 5 F i 6 F o długości 120 cm Pozycja 2 - Introduktor do wprowadzania elektrod 7 F i 8 F o długości 11 cm”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

PYTANIE NR 49: dotyczy części nr 26

„Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności obwód pacjenta do respiratora: jednorazowego użytku, jednorurowy, jednozastawkowy, z drenem sterującym zastawką oraz drenem pomiarowym ciśnienia, o długości 180 cm, gotowy do użycia?

Obwód firmy Philips Respironics dedykowany do respiratorów serii Trilogy.

Zgodnie z instrukcją obsługi producent respiratora zaleca, aby - dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia - używać obwodów dedykowanych (za instrukcją: "Prawidłowe działanie urządzenia, w tym alarmów, z innymi obwodami, nie zostało zweryfikowane przez firmę Philips Respironics.")”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 50: dotyczy części nr 9

„Czy Zamawiający będzie wymagał aby ubieranie, ściąganie lub wymiana okularków nie wymuszały konieczności rozłączania, przemieszczania lub zdejmowania urządzeń podłączonych do twarzy noworodka oraz zmiany pozycji noworodka?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga jak opisał w SWZ.

PYTANIE NR 51: dotyczy projektu umowy

„Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów

faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy??”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w § 2 ust. 7 dopuszcza możliwość przesyłania dokumentów w formie pliku elektronicznego PDF.

PYTANIE NR 52: dotyczy projektu umowy

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:

a) za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 0,1% ceny brutto opóźnionej części dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy

c) za odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto niezrealizowanej części Umowy.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

PYTANIE NR 53: dotyczy części nr 9

„Czy w celu zapewnienia najlepszej ochrony Zamawiający wymaga okularki wykonane z opatentowanego materiału, z dodatkową ochroną na oczy, ale przepuszczającego promienie lecznicze, wykonane z jednej części materiału, z uchwytami na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, w kształcie litery Y, co powoduje, że dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę. Okularki przeznaczone do stosowania u skrajnych wcześniaków i noworodków z wrażliwą i delikatną skórą. Umożliwiają skuteczne umiejscowienie oraz całkowite bezbolesne odklejenie. Dostępne rozmiary: Noworodki, rozmiar 30-38 cm, szerokość 56 mm, identyfikator rozmiaru – kolor turkusowy; Wcześniaki, rozmiar 24-33 cm, szerokość opaski 46 mm, identyfikator rozmiaru – kolor zielony; Mikro, rozmiar 20-28 cm, szerokość opaski 46mm, identyfikator rozmiaru – kolor granatowy. Oznaczenia rozmiarów (naklejki identyfikacyjne) na indywidualnym opakowaniu (nie na okularkach) – jako dodatkowa prewencja incydentów medycznych?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga jak opisał w SWZ.

PYTANIE NR 54: dotyczy części nr 9

„Czy Zamawiający wymaga aby okularki do fototerapii posiadały dodatkową ochronę oczu na poziomie 99,9 % potwierdzoną niezależnymi badaniami?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga jak opisał w SWZ.

PYTANIE NR 55: dotyczy części nr 25

„Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta; system bez zakrzywionej igły i ze zdejmowanym koreczkiem z otworem. Zakrzywiona igła nie ma znaczącego wpływu na zapobieganie zapowietrzeniu systemu pomiarowego.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 56: dotyczy części nr 12, 13, 14, 15

„Prosimy o dopuszczenie filtrów i wymienników mikrobiologicznie czystych.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 57: dotyczy części nr 3, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem w kształcie walca, bez ograniczonej przenikalności N2O, mankiet HI-LO, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 58: dotyczy części nr 5, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści przewodnicę do rurek z niewielką zawartością ftalanów?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 59: dotyczy części nr 5, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści przewodnicę do rurek w rozmiarze 4,7?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 60: dotyczy części nr 5, poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści przewodnicę Bougie pakowaną w opakowanie papier-folia z zabezpieczeniem plastikowym na końcówce, zbiorczo pakowana w kartonik?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 61: dotyczy części nr 5, poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści przewodnicę Bougie wykonaną z materiału o właściwościach poślizgowych, elastyczna, z zagiętym końcem, znaczniki głębokości, bez lateksu i ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku, pakowana w opakowanie papier-folia z zabezpieczeniem plastikowym na końcówce, zbiorczo pakowana w kartonik, rozmiar 2,0 (6Fr)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 62: dotyczy części nr 9, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii z opaską przechodzącą przez główkę dziecka, która nie przepuszcza promieni?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 63: dotyczy części nr 11, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu posiadający filtr w komorze i worku oraz wyposażony w dren o długości 120cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 64: dotyczy części nr 12, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści filtr o oporze przepływu 1,0hPa przy 30l/min?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 65: dotyczy części nr 12, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności nawilżania 32mg/l przy Vt500ml?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 66: dotyczy części nr 12, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści filtr o zwrotnej temperaturze min. 28°C?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 67: dotyczy części nr 12, poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści filtr o oporze przepływu 1,2hPa przy 30l/min?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 68: dotyczy części nr 12, poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności nawilżania 32mg/l przy Vt500ml?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 69: dotyczy części nr 12, poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści filtr o zwrotnej temperaturze min. 28°C?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 70: dotyczy części nr 12, poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści filtr o oporze przepływu 1,0hPa przy 30l/min?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 71: dotyczy części nr 12, poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności nawilżania 30mg/l przy Vt500ml??”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 72: dotyczy części nr 12 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści filtr o zwrotnej temperaturze min. 30°C?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 73: dotyczy części nr 15, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o oporze przepływu 0,5hPa przy 30l/min?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 74: dotyczy części nr 15, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 30mg/l przy Vt500ml?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 75: dotyczy części nr 15, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o zwrotnej temperaturze min. 28°C?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 76: dotyczy części nr 18, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści regulator o zakresie 5-250ml/h?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 77: dotyczy części nr 18, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści aparat z drenem zakończonym łącznikiem luer-lock, bez obrotowego kołnierza?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 78: dotyczy części nr 18, poz. 1

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty potwierdzenia testowania na lipidach aparatu?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie odstąpi od ww. wymogu.

PYTANIE NR 79: dotyczy części nr 27, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści obwód z workiem nie posiadającym uchwytu do zawieszenia?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 80: dotyczy części nr 31, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści łącznik (przedłużacz anestetyczny) o złączu pacjenta 15F/22M oraz o złączu od strony np. obwodu – 22F?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 81: dotyczy części nr 31, poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści łącznik mikrobiologicznie czysty?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 82: dotyczy części nr 35, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o długości 600mm (dla rurek intubacyjnych) oraz o długości 300mm (dla rurek tracheostomijnych)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 83: dotyczy części nr 35, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z 2 otworami bocznymi i 1 otworem centralnym?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 84: dotyczy części nr 35, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z zamykaną liniowo zastawką pacjenta?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 85: dotyczy części nr 35, poz. 1

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu utrzymania systemu zamkniętego podczas bronchoskopii i pobierania próbek?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 86: dotyczy części nr 35, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania wyposażony w klucz do rozmontowania go z rurką?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 87: dotyczy części nr 35, poz. 1

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania nasadki samouszczelniającej oraz nasadki ochronnej do cewnika?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 88: dotyczy części nr 35, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z niewielką zawartością ftalanów?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 89: dotyczy części nr 3, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem w kształcie zaoblonego walca?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 90: dotyczy części nr 5, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści przewodnicę o średnicy 4,7mm? Reszta parametrów zgodna z SWZ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 91: dotyczy części nr 5 poz. 2-3

„Czy Zamawiający dopuści przewodnice jednorazowe pakowane w opakowania typu papier-folia?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 92: dotyczy części nr 5, poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści przewodnice w rozmiarze 6Fr o średnicy 2,0mm dla rozmiaru rurki od 2,0 do 4,0?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 93: dotyczy części nr 10, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania bez karbowanego kołnierza wewnątrz?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 94: dotyczy części nr 10, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w rozmiarze od CH6 o długości 400mm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 95: dotyczy części nr 10, poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania CH6-CH10 o długości 400m?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 96: dotyczy części nr 10, poz. 1-2

„Czy Zamawiający dopuści otwory o średnicy:

- 1,1mm dla CH 6,
- 2,0mm dla CH8,
- 2,2 dla CH10
- 2,5mm dla CH12-14?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 97: dotyczy części nr 10, poz. 5

„Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez zatyczki?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 98: dotyczy części nr 11, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści worki do godzinowej zbiórki moczu z drenem o długości 120cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?”


ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 99: dotyczy części nr 28, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy rozciągliwy z workiem o następujących parametrach:

- Wykonany z wysokiej jakości EVA oraz PP
- Uniwersalne połączenie 22M/15F oraz 22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów oraz urządzeń do wentylacji mechanicznej lub aparatu do znieczulenia
- Regulowana długość obwodu umożliwiająca dopasowanie długości układu oddechowego oraz optymalizację przestrzeni martwej
- Rozciągliwe, karbowane ramiona o długości max 160 cm, połączone łącznikiem Y
- Dodatkowa rozciągliwa rura o długości max 100 cm
- Bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 1 litra lub 3 litrów oraz łącznik
- Rozłączalne kolanko z portem Luer-Lock z koreczkiem
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu?

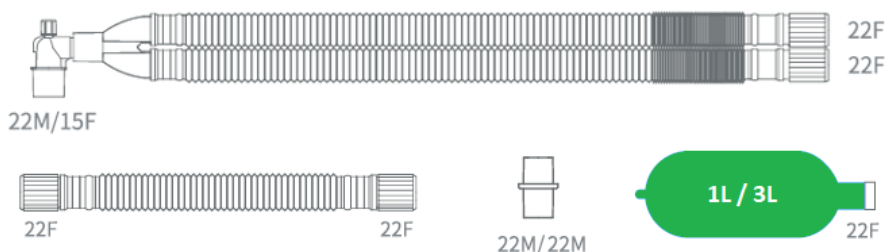

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 100: dotyczy części nr 30, poz. 9

„Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących opisu poszczególnych pozycji w Załączniku nr 2 do SWZ w części nr 30. W związku z zamieszczoną błędną numeracją pozycji w pakiecie 30 w pozycji 9 proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli

- Zgłębnik 100 % poliuretanowy, przeznaczony do żywienia dojelitowego, bezpośrednio do żołądka
 - Wyposażony w dodatkowy port do odbarczania treści żołądkowej, oraz w metalową prowadnicę z kulkową końcówką .
 - Koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit, posiadający podziałkę, znakowanie co 1 cm,
 - Zgłębnik wolny od DEHP, przezroczysty, nie twardniejący przy dłuższym stosowaniu,
 - Sprzęt sterylny, pakowany pojedynczo, wymiana sprzętu nie częściej niż co 6 tygodni.
- W rozmiarze CH14/110cm”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie pomylił numeracji a skomasował opisy. Pozycja 9 Szczegółowego wykazu cen odpowiada pozycji 7 Opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający miał na myśli tak jak opisał w SWZ - zgłębnik 100 % silikonowy.

PYTANIE NR 101: dotyczy części nr 30 poz. 7

„Zwracamy się z prośbą o udzielenia wyjaśnień dotyczących opisu poszczególnych pozycji w Załączniku nr 2 do SWZ w części nr 30. W związku z zamieszczoną błędną numeracją pozycji w powyższym załączniku proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający w pakiecie nr 30 w pozycji 7 miał na myśli:

- Zgłębnik poliuretanowy z prowadnicą, przezroczysty, sterylny w rozmiarze CH10/130?”

ODPOWIEDŹ

Tak - Zgłębnik poliuretanowy z prowadnicą, przezroczysty, sterylny w rozmiarze CH10/130 co odpowiada poz. 6 Opisu przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 102: dotyczy części nr 30 poz. 6

„Zwracamy się z prośbą o udzielenia wyjaśnień dotyczących opisu poszczególnych pozycji w Załączniku nr 2 do SWZ w części nr 30. W związku z zamieszczoną błędną numeracją pozycji w powyższym załączniku proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający w pakiecie nr 30 w pozycji 6 miał na myśli:

- Zgłębnik poliuretanowy z prowadnicą, przezroczysty, sterylny w rozmiarze CH12/110?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający ma na myśli jak opisał w Opisie przedmiotu zamówienia - Zgłębnik poliuretanowy z prowadnicą, przezroczysty, sterylny w rozmiarze CH12/110-130 co odpowiada poz. 8 w szczegółowym wykazie cen.

Zamawiający dopuszcza zgłębnik w rozmiarze CH12/110.

PYTANIE NR 103: dotyczy części nr 30, poz. 5

„Zwracamy się z prośbą o udzielenia wyjaśnień dotyczących opisu poszczególnych pozycji w Załączniku nr 2 do SWZ w części nr 30. W związku z zamieszczoną błędną numeracją pozycji w powyższym załączniku proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający w pakiecie nr 30 w pozycji 5 miał na myśli zestaw do podaży diety w wersji grawitacyjnej do butelki czy zestaw grawitacyjny tzw uniwersalny do worka (packa) i butelki?”

ODPOWIEDŹ

W poz. 5 szczegółowego wykazu cen jest przyrząd do żywienia pack, w poz. 6 szczegółowego wykazu cen jest przyrząd do żywienia na butelkę (poz. 5 i 6 SWC odpowiada poz. 5 OPZ).

PYTANIE NR 104: dotyczy części nr 28, poz. 1

„Proszę o doprecyzowanie czy na pewno oczekują Państwo układu oddechowego z workiem oddechowym. Szpitale, które zamawiają obwody do respiratorów nie wymagają worka oddechowego, a jeśli go wymagają, należałoby, aby obwód miał trzecią rurę.

W przypadku oczekiwania obwodu z workiem proszę dopuszczenie trzeciej rury o długości 90 cm. ”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza układ oddechowy bez worka oddechowego.

PYTANIE NR 105: dotyczy części nr 22

„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego modelu pomp dotyczy zapytanie?”

ODPOWIEDŹ

Dotyczy modelu GW 800.

PYTANIE NR 106: dotyczy części nr 22

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wysyłania próbek w przypadku pakietu 22?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 107: dotyczy części nr 22, poz. 3

„Czy Zamawiający zmieni ilość do 180 lub 210szt? Ponieważ opakowanie zbiorcze zawiera 30szt, a nie rozdzielamy opakowań zbiorczych.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie zmieni ilości.

PYTANIE NR 108: dotyczy części nr 10, poz. 1

„Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika o dł. Min.36-40cm, bez wewnętrznego karbowania łącznika, spełniającego pozostałe wymogi swz.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 109: dotyczy części nr 10, poz. 2

„Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika o dł. min. 56-560cm, bez wewnętrznego karbowania łącznika, spełniającego pozostałe wymogi swz.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 110: dotyczy części nr 11

„Prosimy o doprecyzowanie czy port do pobierania próbek ma być bezigłowy, co zwiększa bezpieczeństwo stosowania i eliminuje ryzyko zakażenia personelu podczas pobierania próbek moczu?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 111: dotyczy części nr 11

„Prosimy o doprecyzowanie czy komora worka ma umożliwiać dokonanie precyzyjnego pomiaru dzięki wyskalowanemu linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 45 do 90 ml co 5 ml i od 100 do 500 ml co 10 ml?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 112: dotyczy części nr 16

„Prosimy o dopuszczenie zaoferowania Sterylnej wody do nawilżania tlenu, 500ml, w jednorazowym pojemniku z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzeniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H₂O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu. Instrukcja użycia dołączona do kartonu zbiorczego lub pojedynczego opakowania.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 113: dotyczy części nr 16

„Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oferowana woda do nawilżania tlenu ma posiadać termin przydatności do użycia minimum 12 miesięcy od daty produkcji, co pozwoli na wykorzystanie wody zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem?”

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami §6 ust. 4 projektu umowy „Wykonawca gwarantuje, że dostarczy towar o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od momentu dostawy. Produkty z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego”.

PYTANIE NR 114: dotyczy części nr 16

„Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy na opakowaniu jednostkowym mają się znajdować oryginalnie nadrukowane przez producenta napisy w języku polskim?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 115: dotyczy części nr 16

„Prosimy o dopuszczenie zaoferowania Sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 340ml z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym (tj 5883 pojemniki po 340ml), ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Sterylizowana bez użycia tlenu etylenu. Posiadająca ciśnieniową zastawkę upustową o czułości 350-700 cm H₂O (5-10 psi). Mieszanina oddechowa rozpraszana jest poprzez system mikrootworów umieszczonych na dnie zbiornika. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN. Na etykiecie napisy w języku polskim. Instrukcja użycia dołączona do kartonu zbiorczego lub pojedynczego opakowania.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 116: dotyczy części nr 16

„Prosimy o dopuszczenie zaoferowania Sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 650ml z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym (tj 3077 pojemniki po 650ml), ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Sterylizowana bez użycia tlenu etylenu. Posiadająca ciśnieniową zastawkę upustową o czułości 350-700 cm H₂O (5-10 psi). Mieszanina oddechowa rozpraszana jest poprzez system mikrootworów umieszczonych na dnie zbiornika. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN. Na etykiecie napisy w języku polskim. Instrukcja użycia dołączona do kartonu zbiorczego lub pojedynczego opakowania.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 117: dotyczy części nr 16

„W związku z dostępnością na rynku pojemników o różnych pojemnościach prosimy o podanie pełnego zapotrzebowania wody w ml i dopuszczenie podania ceny za 1ml w/w wody z dokładnością do 4rech miejsc po przecinku w formularzu cenowym. Pozwoli to na złożenie porównywalnych i konkurencyjnych cenowo ofert.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga jak opisał w SWZ.

PYTANIE NR 118: dotyczy części nr 25

„Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zamkniętego systemu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną j. u. steryny (zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową w komplecie z kompatybilnym workiem do pomiaru diurezy godzinowej), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony, pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. system wyposażony w dwie zastawki antyzwrotne (NRV). Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 119: dotyczy części nr 26

„Prosimy o dopuszczenie zaoferowania Układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,9 m z 2L workiem bezlateksowym.

Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., opór dla całego układu: wdechowy 0,14 cm H₂O i wydechowy 0,16 cm H₂O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm.

W zestawie wewnętrzny (zintegrowany) przewód do próbkowania gazu z łącznikami typu męskiego (część zewnętrzna linii 1,9m), wszystkie elementy w jednym oryginalnym opakowaniu producenta.

Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 120: dotyczy części nr 26

„Prosimy o dopuszczenie zaoferowania

Układu oddechowego jednorurowego, współosiowego, typu rura w rurze, zapewniającego wymianę termiczną, z odłączalnym kolankiem z portem kapno, długości 2,4 m, do respiratora, rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 40 cm. W zestawie linia do próbkowania gazu

długości 3 m z łącznikami typu męskiego, wszystkie elementy w jednym oryginalnym opakowaniu producenta, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 121: dotyczy części 27 i 28

„Prosimy o dopuszczenie Układu oddechowego dwururowego karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 122: dotyczy części nr 33, poz. 4

„Prosimy o sprecyzowanie czy przedłużacz ma być transparentny w celu wizualizacji drogi podawanego płynu?”

ODPOWIEDŹ

Według opisu przedmiotu zamówienia przedłużacze mają być przezroczyste czyli transparentne.

PYTANIE NR 123: dotyczy części nr 10, poz. 1-2

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewników CH4-CH8 o długości 40cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 124: dotyczy części nr 10, poz. 1-2

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewników bez karbowania.?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

UWAGA:

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ oraz terminu składania i otwarcia ofert. Zmiany treści SWZ wraz z terminem składania i otwarcia ofert zostaną udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania po publikacji ogłoszenia zmian w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

z up. p.o. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr Magdalena Sikora
Z-CIA DYREKTORA
ds. Technicznych i Administracyjnych